



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0180—2013  
代替 YY/T 0180—1994

---

## 眼 睑 拉 钩

Eyelid retractors

2013-10-21 发布

2014-10-01 实施

---

国家食品药品监督管理总局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 YY/T 0180—1994《眼睑拉钩》。

本标准与 YY/T 0180—1994 的主要区别如下：

- 增加了结构型式和尺寸规格；
- 取消了对手柄的要求；
- 增加了选用的材料；
- 增加了连接式结构的牢固要求和试验方法；
- 增加了压力蒸汽试验法的要求和试验方法。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会(SAC/TC 94)提出并归口。

本标准主要起草单位：苏州六六视觉科技股份有限公司、上海市医疗器械检测所。

本标准主要起草人：张建平、郑强。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 8663—1988；
- YY/T 0180—1994。

# 眼 睑 拉 钩

## 1 范围

本标准规定了眼睑拉钩的型式和材料、要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存等要求。  
本标准适用于眼科检查时作拉开眼睑用的眼睑拉钩(以下简称拉钩)。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1220—2007 不锈钢棒

YY/T 0149—2006 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法

YY/T 0171—2008 外科器械 包装、标志和使用说明书

YY/T 1052 手术器械标志

## 3 型式和材料

3.1 拉钩由头部和手柄组成,分整体式和连接式。

3.2 拉钩的头部形式、基本尺寸应符合图 1 和表 1 的规定。

注:手柄形状、尺寸本标准不作规定。

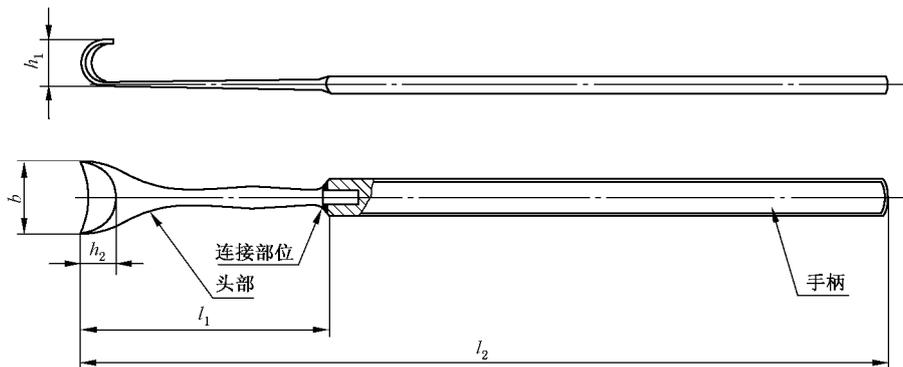


图 1 拉钩结构型式