

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0217.2—1995

口服液瓶超声波式清洗机

1995-12-22 发布

1996-10-01 实施

国家医药管理局 发布

口服液瓶超声波式清洗机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了口服液瓶超声波式清洗机的产品分类,技术要求,试验方法和检验规则,标志、包装、运输和储存等内容。

本标准适用于口服液瓶超声波式清洗机(以下简称清洗机)。该产品主要用于清洗口服液瓶,亦可适用于其他清洗方式的洗瓶机。


2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 5226 机床电气设备通用技术条件
- GB 6168 层流洁净工作台检验标准
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法
- YY 0056 管制口服液瓶
- YY/T 0216 制药机械产品型号编制方法
- YY/T 0076 金属制件镀层分类、技术条件

3 产品分类

3.1 型号表示方法

清洗机的型号表示方法应符合 YY/T 0216 的规定。

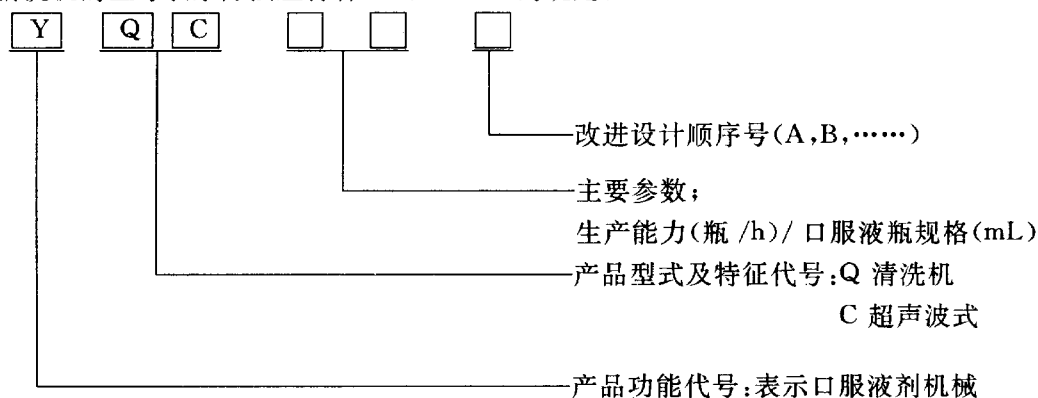

型号示例:

YQC 8 000/10 C 第三次改进设计 10 mL 灌装量每小时 8 000 瓶的口服液瓶超声波式清洗机。

3.2 型式