



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0173.4—2005

代替 YY/T 0173.4~0173.6—1994, YY/T 0173.8—1994

手术器械

唇头钩 唇头齿 锁止牙 蛋形指圈

Surgical instruments—Teeth, serration, ratchet and elliptoid ring

2005-07-18 发布

2006-06-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

前 言

本标准代替 YY/T 0173.4—1994《手术器械 唇头钩》、YY/T 0173.5—1994《手术器械 唇头齿》、YY/T 0173.6—1994《手术器械 锁止牙》、YY/T 0173.8—1994《手术器械 蛋形指圈》。

本标准合并 YY/T 0173.4—1994《手术器械 唇头钩》、YY/T 0173.5—1994《手术器械 唇头齿》、YY/T 0173.6—1994《手术器械 锁止牙》、YY/T 0173.8—1994《手术器械 蛋形指圈》的内容,更名为 YY/T 0173.4—2005《手术器械 唇头钩 唇头齿 锁止牙 蛋形指圈》。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂。

本标准主要起草人:章红霞。

本标准所代替标准的历次版发布情况:

——GB 3056—1982、YY/T 0173.4—1994;

——WS₂-62—1976、WS₂-63—1976、WS₂-128—1976、GB 3055—1989、YY/T 0173.5—1994;

——GB 2765—1981、YY/T 0173.6—1994;

——GB 2764—1981、YY/T 0173.8—1994。

手术器械

唇头钩 唇头齿 锁止牙 蛋形指圈

1 范围

本标准规定了手术器械唇头钩、唇头齿、锁止牙和蛋形指圈的分类、要求。

本标准适用于供手术器械产品设计唇头钩、唇头齿、锁止牙和蛋形指圈时选用。

2 分类

2.1 唇头钩

2.1.1 型式和尺寸

唇头钩的型式和基本尺寸应符合图1和表1的规定。

2.1.2 标记示例

$b=3.2\text{ mm}$ $H=4.0\text{ mm}$ 的 1×2 唇头钩

标记为: 1×2 唇头钩 3.2×4.0 YY/T 0173.4—2005

$b=3.2\text{ mm}$ $H=2.8\text{ mm}$ $P=1\text{ mm}$ 的 2×3 唇头钩

标记为: 2×3 唇头钩 $3.2\times 2.8\times 1$ YY/T 0173.4—2005

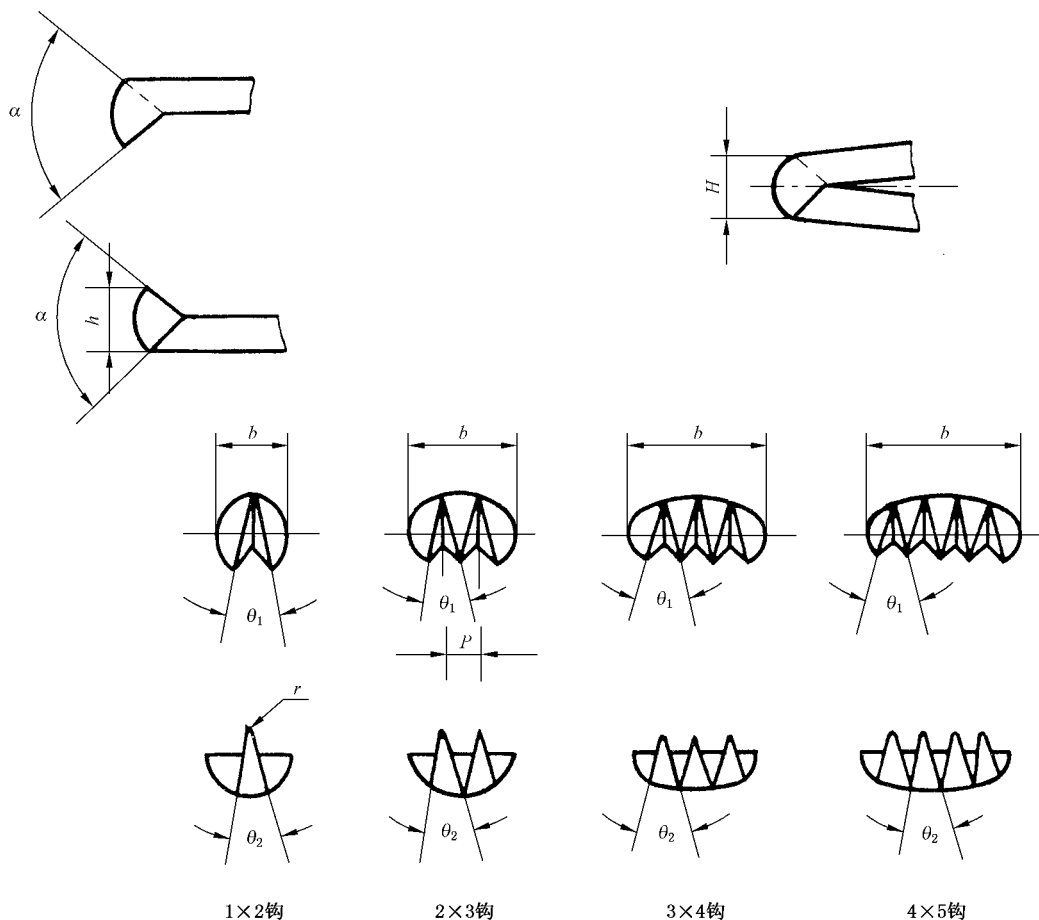


图 1 唇头钩